SAKAImed

足受けボード

BEQ-10

取 扱 説 明 書

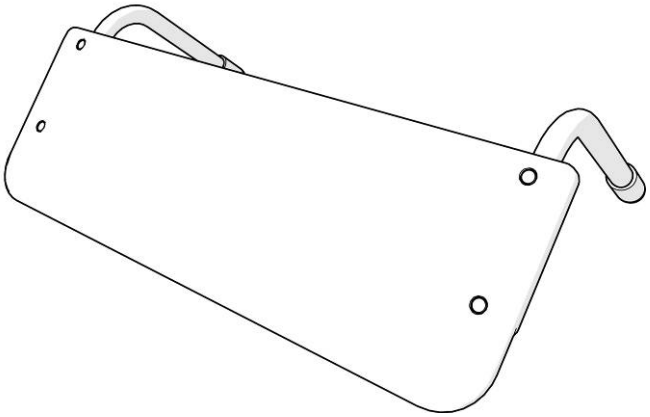

ご使用になる前に ····· 3
- 安全上のご注意 ····· 3
- 各部の名称 ····· 5
- 組み合わせ ····· 6
- 始業点検について ····· 7

使用方法 ····· 8
- 浴槽への設置 ····· 8
- 入浴中 ····· 9
- 清掃 ····· 10

機器について ····· 11
- 保証とアフターサービス ····· 11
- 仕様 ····· 12

●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

●「取扱説明書」は
- １部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。
- １部を保存用として、大切に保管してください。

用 途

本製品は、当社浴槽『ユニバス』、『パンジーi シンプルセット』専用の足受けボードです。
組み合わせて使用することで、入浴中の姿勢保持を安全に行うことができます。

ご使用になる前に

安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

表示について

危険や損害の程度を以下に区分し、表示しています。

⚠ 危険	取り扱いを誤ると、**「死亡または重傷を負うことに至る」**ことを示しています。
⚠ 警告	取り扱いを誤ると、**「死亡または重傷を負う可能性が想定される」**ことを示しています。
⚠ 注意	取り扱いを誤ると、**「傷害または物的損害の発生が想定される」**ことを示しています。

絵表示の意味

⃠ 禁止	行為を禁止することを示した表示です。
❗ 強制	必ず実行していただくことを示した表示です。

ご使用になる前に／安全上のご注意

足受けボード本体

⚠警告

用途以外の目的に使用しない

思わぬけがをする恐れがあります。

足受けボードの上に立たない

思わぬけがをしたり、機器が破損したりする恐れがあります。

⚠注意

指定浴槽以外では使用しない

足受けボードや浴槽が破損する恐れがあります。

浴槽への設置時

⚠注意

使用前に破損箇所等がないか点検する

破損したまま使用すると、思わぬけがの恐れがあります。

ゴム足が 4 点接地され、ガタつかないことを確認する

固定されていない状態で使用すると、思わぬけがの恐れがあります。

足受けボードをリフトの下に置かない

ユニバス（UCB-100）で使用する場合は、リフトの下に挟み込まないよう注意してください。
機器が破損、故障する恐れがあります。

使用時

⚠注意

入浴者の足先を注視する

足受けボードと浴槽の隙間に指先を挟み込むと、思わぬけがの恐れがあります。

高温の湯中に放置しない

変形・変色の恐れがあります。

足受けボードを移動させるときは、落下に注意する

思わぬけがをしたり、機器が破損したりする恐れがあります。特に濡れた手で移動させる場合は十分に注意してください。

ご使用になる前に

各部の名称

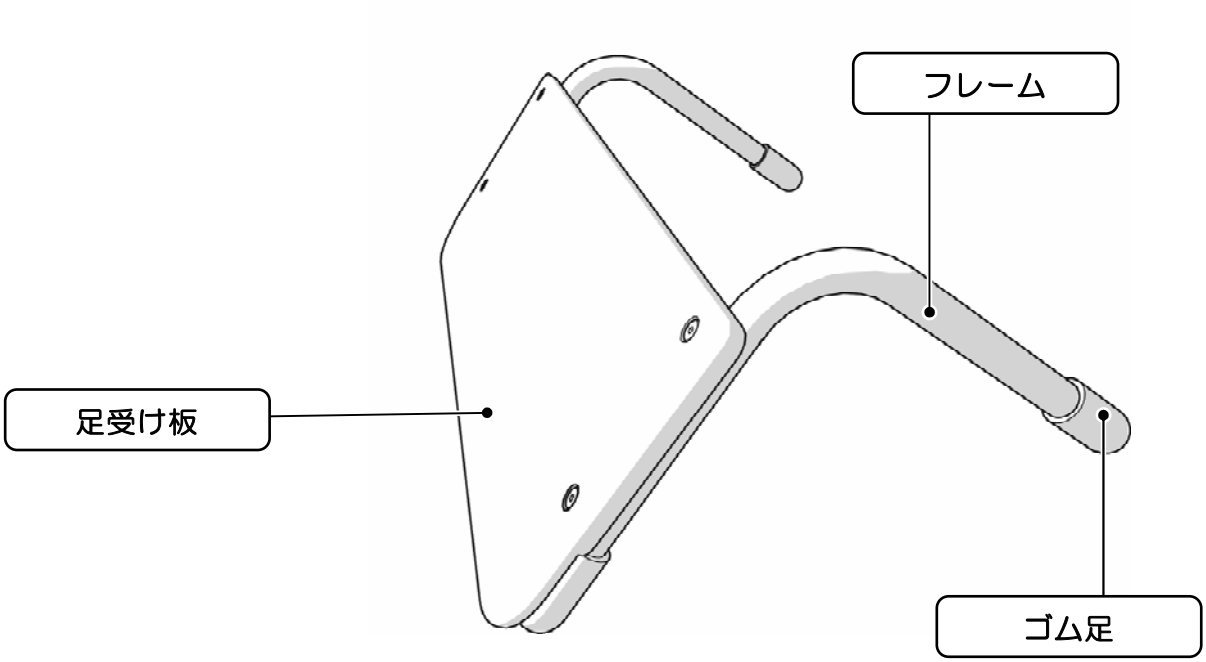

ご使用になる前に

組み合わせ

本製品は、当社浴槽『ユニバス』及び『パンジーi シンプルセット』専用の足受けボードです。
必ず対象浴槽と組み合わせてご使用ください。

対象浴槽

・ユニバス　・・・・UCB-100

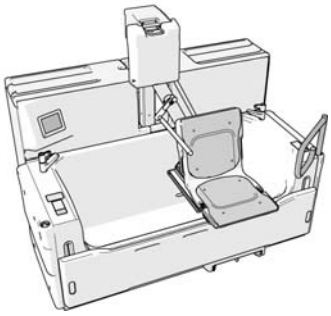

⚠ **注意　ユニバス専用入浴用車椅子(UCB-100C,UCB-110C)と一緒に使用しない**

車椅子と足受けボードの隙間に足を挟み込んでしまうと、思わぬけがの恐れがあります。また、車椅子と足受けボードがぶつかり、機器が破損する恐れがあります。必ず、座面入浴及び直接入浴時にご使用ください。

・パンジーi シンプルセット　・・・・PNS-300,300AC,300H,300ACH

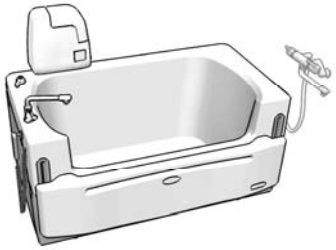

⚠ **注意　パンジーiシリーズのスタンダードセット(PNS-310等)、パーソナルセット(PNS-320等)に使用しない**

昇降ユニットと足受けボードの隙間に足を挟み込んでしまうと、思わぬけがの恐れがあります。パンジーiでは、昇降リフトのない浴槽にご使用ください。

『ユニバス』や『パンジーi シンプルセット』の操作方法については、各浴槽の取扱説明書をご覧ください。

ご使用になる前に

始業点検について

ご使用前に**始業点検項目**にもとづき、始業点検を実施してください。

①足受け板に毛羽立ちや目立った傷、ヒビ割れ等の破損はありませんか?

②フレームに緩みやガタつき等の異常はありませんか？

③ゴム足に破損はありませんか?

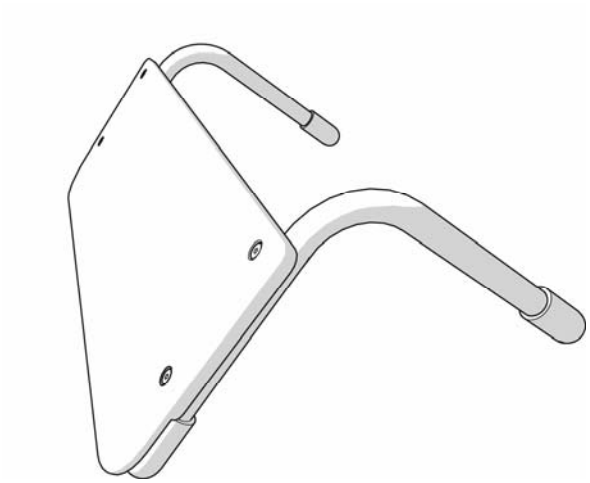

点検の際は、本ページをコピーしてご使用ください

始業点検チェックリスト：足受けボード（BEQ-10）　　点検日　　年　　月　　日

項目	点検内容	点検方法	チェック	備考
①	足受け板の破損	目視	□ OK・□ NG	
②	フレームの緩み・ガタつき	大きなガタつきが無いことを確認。	□ OK・□ NG	
③	ゴム足の破損	目視	□ OK・□ NG	

これ以外でも部品が破損しているなど、日頃お使いになられていたときとは違う異常を感じましたら、本製品を使用せずに、最寄りの営業所にご連絡ください。尚、故障中は故障した機器を誤って使用しないように、周囲の方が分かるように表示（故障中の貼り紙等）をお貼りください。

使用方法

足受けボードが必要な入浴者が入浴する場合のみお使いください。

浴槽への設置

ゴム足 4 箇所が浴槽の壁面と底面につくように設置してください。
設置後は、必ず手で動かし、ガタつきがないことを確認してからご使用ください。

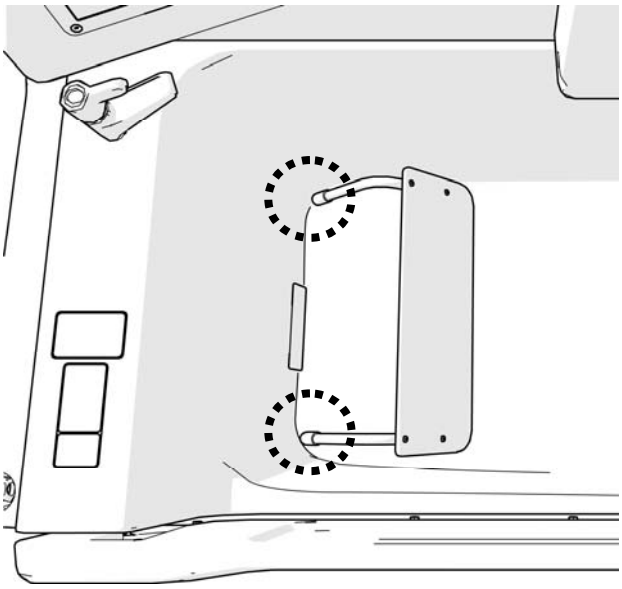

⚠ 注意

入浴中に設置する場合は、以下の点に注意する

・足受けボードの下に、入浴者の足を挟みこまないように注意する

思わぬけがの恐れがあります。

・足受けボードを移動させるときは、落下に注意する

思わぬけがをしたり、機器が破損したりする恐れがあります。特に濡れた手で移動させる場合は十分に注意してください。

使用方法

入浴中

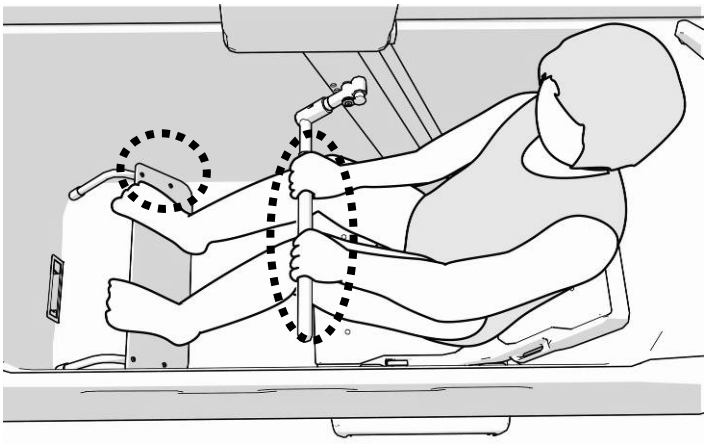

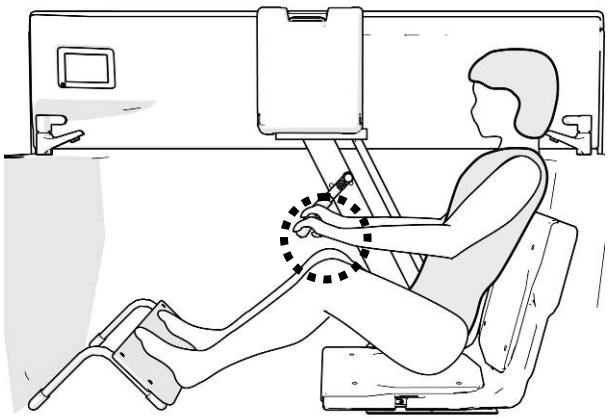

⚠ 注意

・浴槽と足受けボードとの隙間に、入浴者の足を挟みこまないように注意する

思わぬけがの恐れがあります。

・直接入浴で使用する場合は、移乗中足受けボードにつまずかないように注意する

思わぬけがをしたり、機器や浴槽が破損したりする恐れがあります。

ユニバス(UCB-100)と併せて使用する場合は、以下の点に注意する

・浴槽の左側へ入浴する場合は、送湯口に注意する

入浴中及び座面昇降時に入浴者の足が送湯口に近づきますので、挟み込まないように注意してください。思わぬけがの恐れがあります。

・リフト昇降時は、入浴者の足（ひざ周辺）と浴槽内手すりの隙間に注意する

浴槽内手すりと入浴者の足（ひざ周辺）との隙間が狭くなるので注意してください。入浴者が足をぶつけてしまうと、思わぬけがの恐れがあります。

・リフト下降時は、足受けボードの位置に注意する

リフト下に足受けボードを挟み込んでしまうと、機器が破損する恐れがあります。

日常のお手入れ

清掃

1. やわらかい布または、やわらかいスポンジに浴室用中性洗剤を含ませ、汚れを落とします。

推奨品：酒井医療㈱「浴槽クリーナ A」



お願い

・中性洗剤をかけたまま放置しないでください。

・強くこすらないでください。キズの原因になります。

⚠ **注意**

・タワシやブラシは使わない

・研磨材がついたスポンジや、ネットに包まれたスポンジは使わない

2. フレームや足受け板についている泡をシャワーで十分洗い流します。

お願い

・泡が残っているとカビが発生しやすくなります。

・お湯で洗い流した場合、最後は水で洗い流してください。

3. 乾いた布で水滴を軽く拭き取ります。

お願い

・水滴を残すと水垢などが残り、くすみの原因となります。

⚠ **注意　使用後は、換気を行い浴室内の温度・湿度を下げる**

湿気による錆やかびなどの発生を抑えます。

機器について

保証とアフターサービス

保証書と保証期間

・保証書（別添）は再発行致しませんので紛失されないよう大切に保管してください。
保証書がないと保証期間中でも有償修理とさせていただく場合があります。
・保証期間は 1 年です。但しフレームは 5 年間です。保証の規定につきましては保証書をご覧ください。

修理をご依頼いただく場合

・修理をご依頼いただく場合は、下記のことをお知らせください。

機種名　　：　*BEQ-10*
お買い上げ：　　年　　月　　日
故障状況(できるだけ詳細に)
住所，氏名，電話番号

・メーカーより指示のあるとき以外は、機器を分解したりしないでください。

耐用期間

10 年：保守点検などの当社推奨環境で使用された場合

損耗品（使用により、磨耗･劣化･変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）

・正常な使用において、交換の目安が**約 2 年**のもの。

ゴム足


損耗品の交換時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。
点検して必要により有償交換いたします。

保守用性能部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は、販売中止後 10 年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。

機器について

仕様

型　　式		BEQ-10
外形寸法（L×W×H）		329×540×153
質　　量		約 3.2 kg
材　　質	足受け板	プラスチック
	フレーム	ステンレス
	ゴム足	プラスチック

注．都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。